


Ultraschallspitzen

Kompatibel mit KaVo *1

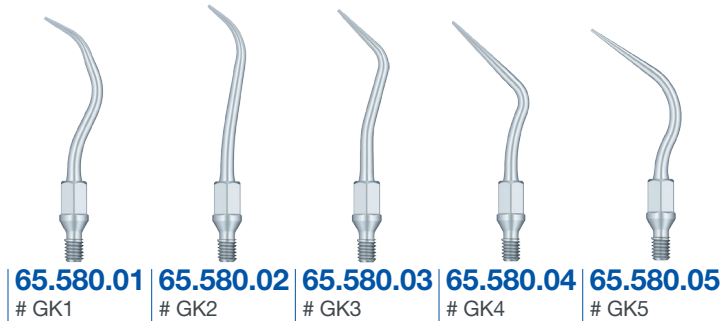

65.580.01 # GK1 **65.580.02** # GK2 **65.580.03** # GK3 **65.580.04** # GK4 **65.580.05** # GK5

KaVo SONICflex kompatibel



65.580.21 # GC1 **65.580.22** # GC2

KaVo SONOsoft kompatibel

65.570.01
Drehmomentschlüssel
für Ultraschallspitzen

► Mindestbestellung 3 Spitzen, gemischt möglich ◀

Artikelnummer	Artikelbezeichnung kompatibel mit KaVo SONICflex / SONOsoft	Menge	Bestellmenge
65.580.01 *	Scaling Spitze # GK1	1 Stück	
65.580.02 *	Paro Spitze # GK2	1 Stück	
65.580.03 *	Paro Spitze # GK3	1 Stück	
65.580.04 *	Paro Spitze # GK4	1 Stück	
65.580.05 *	Scaling Spitze # GK5	1 Stück	
65.580.21 *	Scaling Spitze # GC1	1 Stück	
65.580.22 *	Scaling Spitze # GC2	1 Stück	
65.570.01	Drehmomentschlüssel	1 Stück	


CE Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.
* Benannte Stelle des Herstellers Fa. Woodpecker = CE 0197

*1 KaVo SONICflex und KaVo SONOsoft sind eingetragene Warenzeichen der Firma KaVo Dental GmbH. Die Firma DCV-INSTRUMENTE GmbH steht in keiner wirtschaftlichen Verbindung mit diesem Unternehmen.

Kompatibel mit SIRONA *2



65.581.01 # GS1 **65.581.02** # GS2 **65.581.03** # GS3 **65.581.04** # GS4 **65.581.05** # GS5

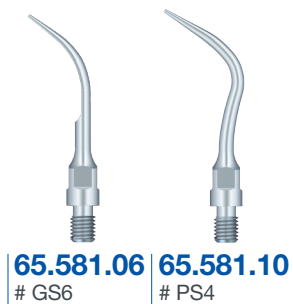

65.581.06 # GS6 **65.581.10** # PS4

65.570.02
Drehmomentschlüssel
für Ultraschallspitzen

► Mindestbestellung 3 Spitzen, gemischt möglich ◀

Artikelnummer	Artikelbezeichnung kompatibel mit SIRONA	Menge	Bestellmenge
65.581.01 *	Scaling Spitze # GS1	1 Stück	
65.581.02 *	Paro Spitze # GS2	1 Stück	
65.581.03 *	Paro Spitze # GS3	1 Stück	
65.581.04 *	Paro Spitze # GS4	1 Stück	
65.581.05 *	Scaling Spitze # GS5	1 Stück	
65.581.06 *	Scaling Spitze # GS6	1 Stück	
65.581.10 *	Scaling Spitze # PS4	1 Stück	
65.570.02	Drehmomentschlüssel	1 Stück	


CE Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.
* Benannte Stelle des Herstellers Fa. Woodpecker = CE 0197

*2 SIRONA ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Sirona Dental Systems GmbH. Die Firma DCV-INSTRUMENTE GmbH steht in keiner wirtschaftlichen Verbindung mit diesem Unternehmen.

Weitere Informationen und das Bestellformular auf der Rückseite

Ultraschallspitzen

Kompatibel mit EMS *3

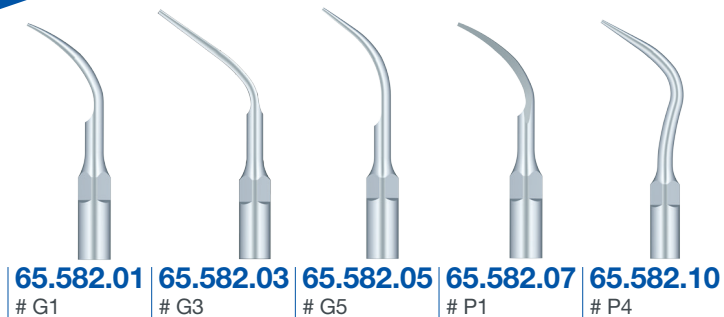

65.582.01 # G1 **65.582.03** # G3 **65.582.05** # G5 **65.582.07** # P1 **65.582.10** # P4

EMS kompatibel



65.570.03

Drehmomentschlüssel für Ultraschallspitzen


► Mindestbestellung 3 Spitzen, gemischt möglich ◀

Artikelnummer	Artikelbezeichnung kompatibel mit KaVo SONICflex / SONOsoft	Menge	Bestellmenge
65.582.01*	Scaling Spitze # G1	1 Stück	
65.582.03*	Scaling Spitze # G3	1 Stück	
65.582.05*	Scaling Spitze # G5	1 Stück	
65.582.07*	Paro Spitze # P1	1 Stück	
65.582.10*	Paro Spitze # P4	1 Stück	
65.570.03	Drehmomentschlüssel	1 Stück	

CE Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen. * Benannte Stelle des Herstellers Fa. Woodpecker = CE 0197

*3 EMS ist eingetragenes Warenzeichen der E.M.S. - Electro Medical Systems S.A. Die Firma DCV-INSTRUMENTE GmbH steht in keiner wirtschaftlichen Verbindung mit diesem Unternehmen.

Aufbereitung (Abbildungen M 1:2)

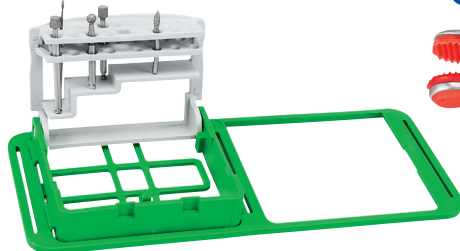

PractiPal® Bohrerständer
Zur Aufbereitung von maximal 2 RAL-, 5 RA- und 8 FG-Bohrern

85.075.03 ■

PractiPal® Bohrerständer, grün

Ohne Abbildung:

85.075.01 ■

PractiPal® Bohrerständer, grau

85.075.02 ■

PractiPal® Bohrerständer, gelb



AS1294-25

Förster Instrumenten-Fasszange, 20 cm, inkl. Gummibacken

07.HT512FG

EKR-Bohrer, Hartmetall, 0,12, 5 Stück Packung

07.HT514FG

EKR-Bohrer, Hartmetall, 0,14, 5 Stück Packung

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Bestellmenge
AS1294-25	Förster Instrumenten-Fasszange, 20 cm, inkl. Gummibacken	1 Stück	
07.HT512FG	EKR-Bohrer, Hartmetall, 0,12, VPE 5 Stück, D+Z	1 VPE	
07.HT514FG	EKR-Bohrer, Hartmetall, 0,14, VPE 5 Stück, D+Z	1 VPE	
85.075.01	*PractiPal® Bohrerständer, grau, sterilisierbar	1 Stück	
85.075.02	*PractiPal® Bohrerständer, gelb, sterilisierbar	1 Stück	
85.075.03	*PractiPal® Bohrerständer, grün, sterilisierbar	1 Stück	

CE Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

* ParactiPal® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Directa. Die Firma DCV-INSTRUMENTE GmbH steht in keiner wirtschaftlichen Verbindung mit dem o.g. Unternehmen.

Bestellservice:

Änderungen vorbehalten. | Stand April 2019

Senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an **07464 / 20 09** oder bestellen Sie telefonisch unter **07464 / 22 00**

Kundennummer

Unternehmen / Praxis

Telefon / Fax

Straße, Hausnummer

E-Mail

** Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Verkaufsempfehlung zzgl. MwSt. Irrtümer und Preiskorrekturen vorbehalten.

Postleitzahl, Ort

Datum / Unterschrift, Firmen- / Praxisstempel

Wir wünschen den Besuch eines Außendienstmitarbeiters, der in unserer Praxis die Produkte vorstellt:
Unser gesamtes Produktsortiment, sowie aktuelle Sonderaktionen finden Sie in unserem Online-Shop System unter:

www.dcv-instrumente.de

